



Tecnologia da Informação

Sistemas DATASUS

Código
MaBPA01

Versão
01.00

Início da Vigência
00/00/0000

Título

MANUAL DE ATUALIZAÇÃO BPAMAGNÉTICO

Área Responsável

Centro de Informação em Saúde - CIS


1. O primeiro passo para se fazer a atualização do sistema de BPAMagnético é saber qual a versão do sistema e da base de dados que está sendo utilizada, para isso basta conferir no rodapé do Programa.




VERSÃO DO BANCO DE DADOS

VERSÃO DO APLICATIVO


2. Para conferir se o **APLICATIVO** está atualizado, basta entrar no site <http://sia.datasus.gov.br> e clicar no botão de BPA-MAGNÉTICO

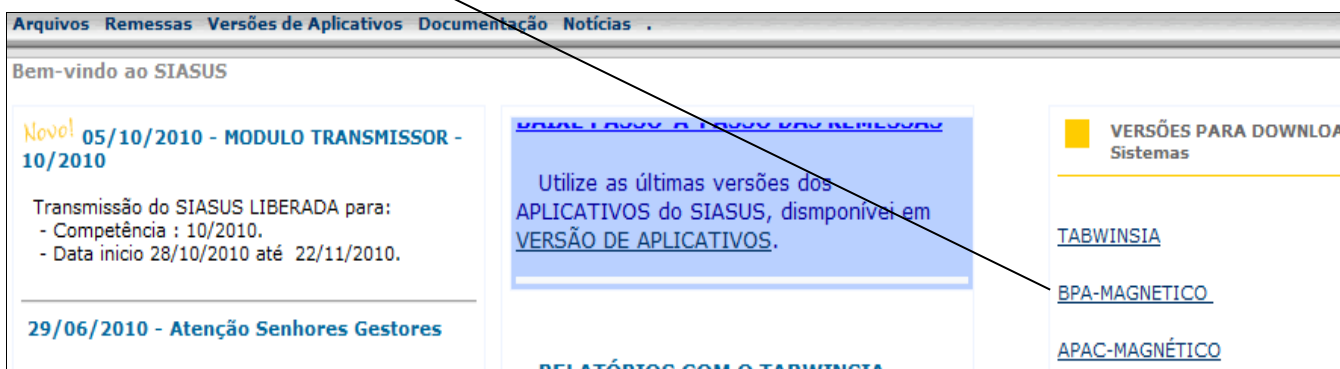


3. A tela de downloads do aplicativo se abrirá, o arquivo BPA<versão>.EXE que estiver na tela, sempre é a versão mais recente do aplicativo, se é o mesmo que você está utilizando não precisa fazer nada, mas no caso de ser uma versão mais recente clique duas vezes no arquivo para fazer o download.

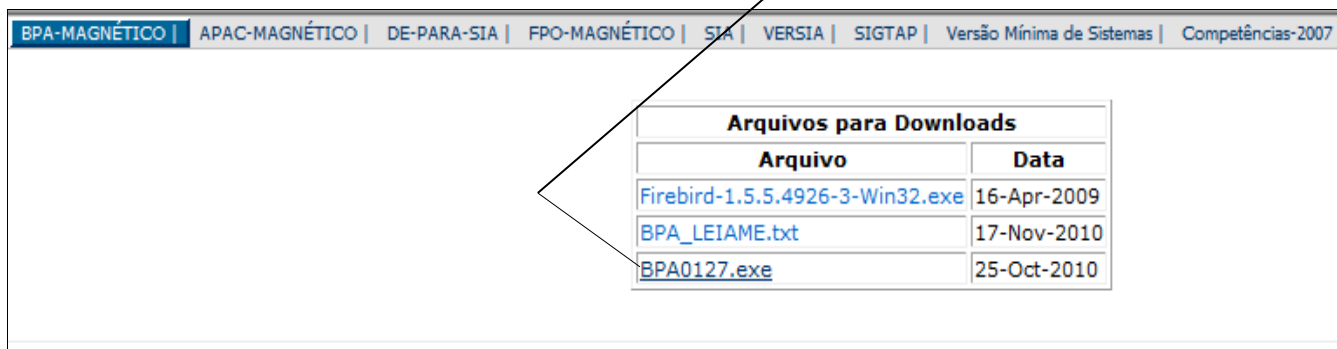

4. Assim a tela de download se abrirá, clique no botão para baixar

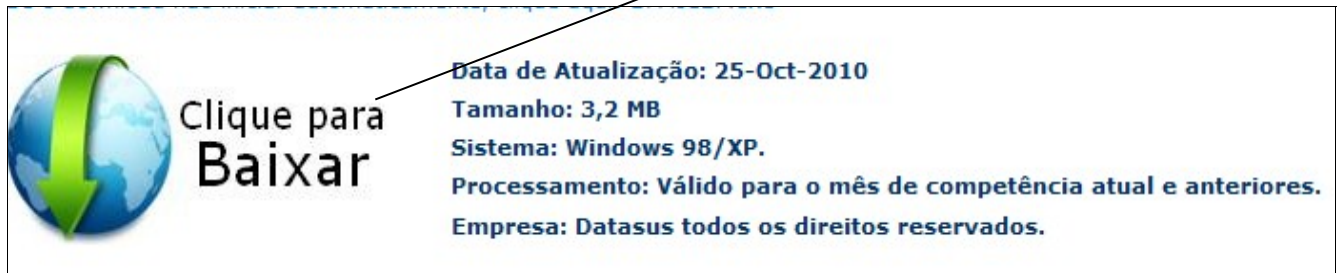


5. Em seguida clique em salvar e escolha o diretório em que vai ser salvo o arquivo. Exemplo: [C:\DATASUS\BPA](#)

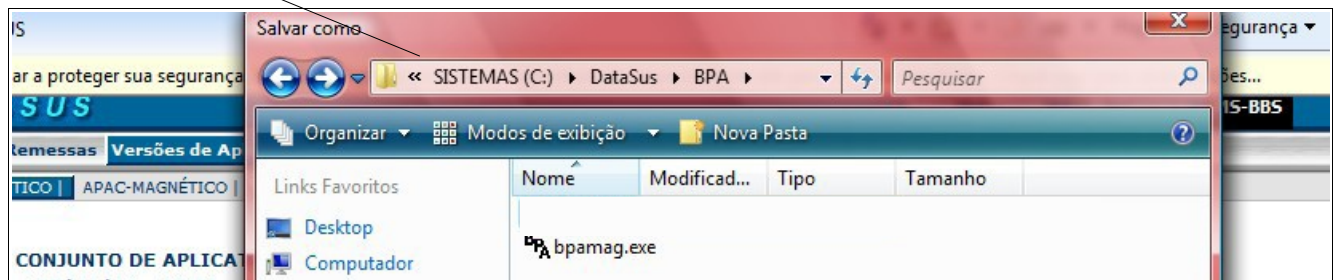

6. Feito isso, entrar na pasta que foi salvo o arquivo. Exemplo: [C:\DATASUS\BPA](#) e clique duas vezes no aplicativo que você baixou, para extrair as informações


Nome	Modificado em	Tipo	Tamanho
BPA0127.exe	25/11/2010 10:19	Aplicativo	3.276 KB
BPA_LEIAME.txt	25/10/2010 14:06	Documento de texto	9 KB

7. Abrirá a tela de extração de arquivos, clique em executar, em seguida clique em Browse e escolha onde será extraído o arquivo. Exemplo: [C:\DATASUS\BPA](#) em seguida clique em Unzip.

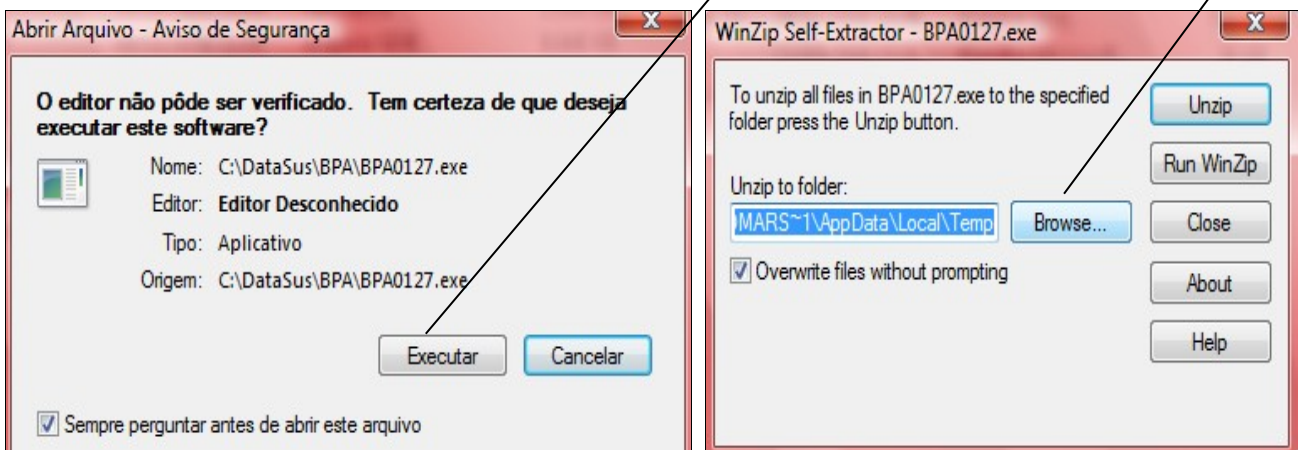

Obs.: Dependendo Sistema Operacional apenas aparecerá uma tela solicitando a instalação, assim é só clicar em INSTALAR e em seguida SIM PARA TODOS.

Dica: Caso já exista os arquivos na pasta, abrirá uma tela MSDOS avisando que os arquivos já existem e se deseja substituir, caso isto aconteça clique y no teclado em seguida enter.

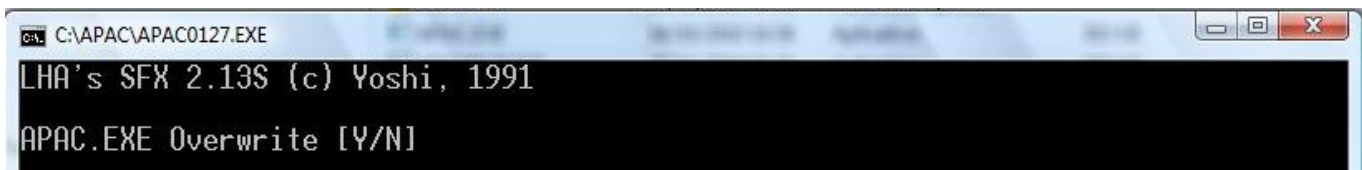


Dessa forma sua Versão do Aplicativo foi atualizada.

8. Para conferir se a **VERSÃO DO BANCO DE DADOS** está atualizado, volte ao site <http://sia.datasus.gov.br> clique novamente no botão de BPAMagnético e em seguida na aba SIA.




9. O primeiro arquivo BDSIA<versão>.exe que aparece na lista é sempre a versão mais recente do banco de dados, no formato de BDSIA<ano/mes/letra>.exe, baixe o BDSIA da competência em vigência (ex: se for competência 03/2012 será o BDSIA201203, competência 04/12 BDSIA201204, etc), clique duas vezes no arquivo, em seguida CLIQUE PARA BAIXAR e escolha o diretório em que vai ser salvo o arquivo. Exemplo: <C:\DATASUS\BPA>

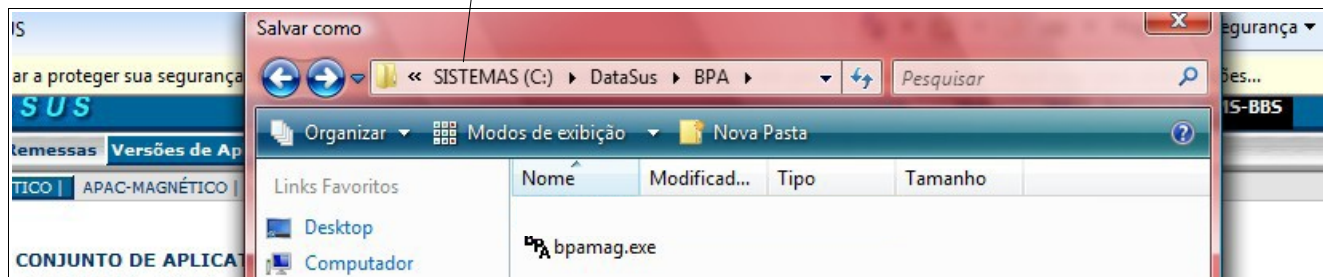

Obs.: Se o arquivo já existir aparecerá uma tela do DOS (tela preta), dessa forma digite a letra "A" e de clique "ENTER".

10. Depois de salvo o arquivo, abra a pasta do BPA que se encontra. Exemplo [C:\DATASUS\BPA](#) clique duas vezes no arquivo BDSIA<versão>.exe que você salvou e execute o mesmo. Abra o Programa do BPAMagnético, vá em OPERAÇÃO > IMPORTAR TABELAS NACIONAIS DO KIT BPA > verifique se está selecionada a pasta correta onde você salvou os arquivos. Exemplo: [C:\DATASUS\BPA](#) e clique em IMPORTA

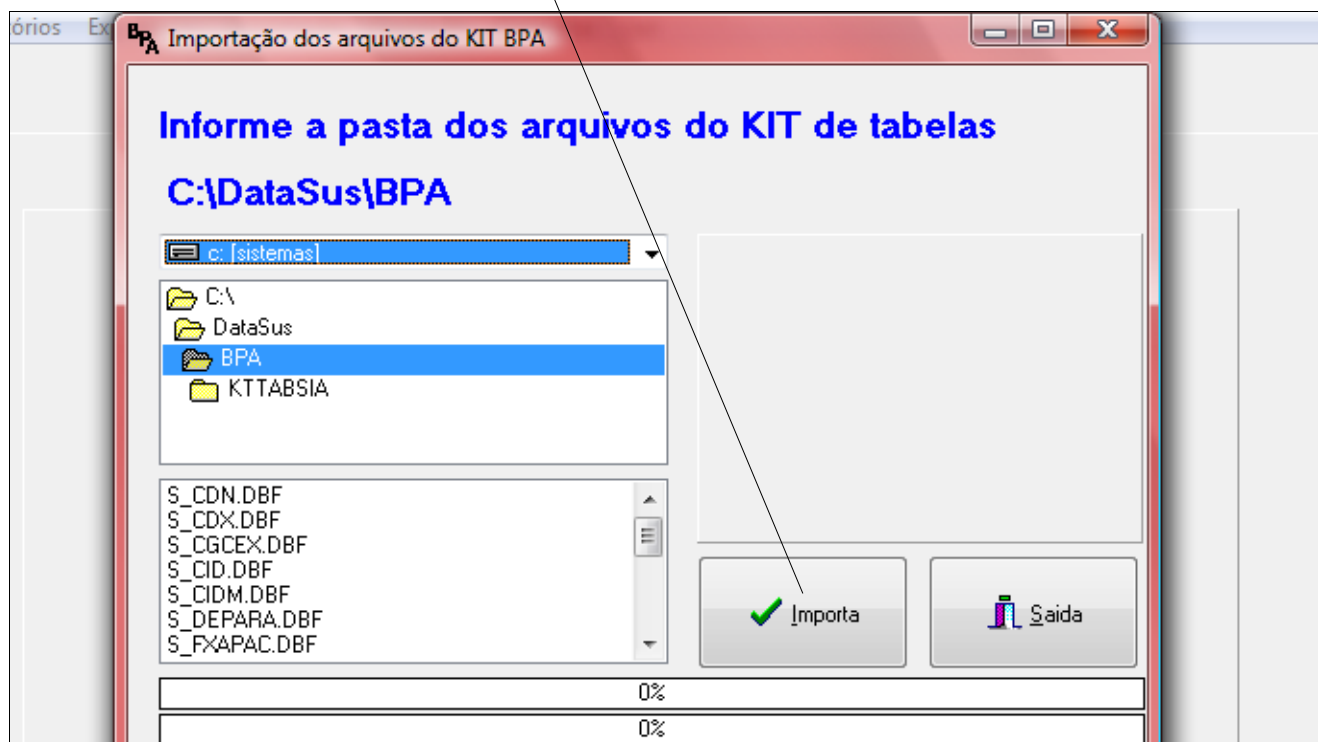

Espera-se processar a atualização e não utilize nenhuma outra tela enquanto os arquivos estiverem sendo atualizados para evitar falha na importação, terminando clique em OK, feche o programa, abra novamente o BPAMagnético e verifique se a versão está correta.

**ASSINATURAS
DE
APROVAÇÃO**

COMISSÃO DE PROCESSOS OPERACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA DE SAÚDE